

発行番号 18L- 693

(株)岩本機工様

発行日 2018年11月26日

## 校正証明書

### チルチングレベル

品名 TTL6

機械番号 29281

校正日 2018年11月26日


上記の製品は、JSIMA規格に基づき日本測量機器工業会の定めた作業標準による校正の結果、その基準を満たしていることを証明します。

实用標準機

機械名 B21

製造番号 408831

株式会社 レント「測機・工具センター」  
〒426-0002 静岡県藤枝市横内849-1  
TEL :054-645-6615  
FAX :054-643-1177



部門責任者 

本校正・検査は、一般社団法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。

事業者認定番号 J 1509001

検査員認定番号 J 2509018

発行番号 18L- 693

(株)岩本機工 様

発行日 2018年11月26日

## 検査成績書

### チルチングレベル

TTL6

機械番号 29281

検査日 2018年11月26日

社内検査の結果、下記の通り合格したことを証明致します。

No	種類	検査項目	測定結果	許容値	
1	チルチング レベル	水平精度	0 "	7 " 以下	
		視軸の偏差	0.1 mm	0.5 mm以下	
2	オートレベル	水平精度	- "	15 " 以下	
		視軸の偏差	- mm	0.5 mm以下	
		自動補正精度	- "	15 " 以下	
		自動補正範囲	- ' 以上	- ' 以上	
3	電子レベル	水平精度	光学読み	- "	15 " 以下
			電子読み	- "	15 " 以下
		視軸の偏差	- mm以下	0.5 mm以下	
		自動補正精度	- "	15 " 以下	
		自動補正範囲	- ' 以上	- ' 以上	

本検査は日本測量機器工業会規格((JSIMA103:2007)に定められた測定方法に従って行われています。

実用標準機

機械名/B21


製造番号/408831

株式会社 レント「測機・工具センター」

〒426-0002 静岡県藤枝市横内849-1

TEL :054-645-6615

FAX :054-643-1177



部門責任者



検査者




本校正・検査は、一般社団法人 日本測量機器工業会が認定した事業者及び検査員により実施されています。

事業者認定番号 J 1509001

検査員認定番号 J 2509018

# 測量機 トレーサビリティ体系図

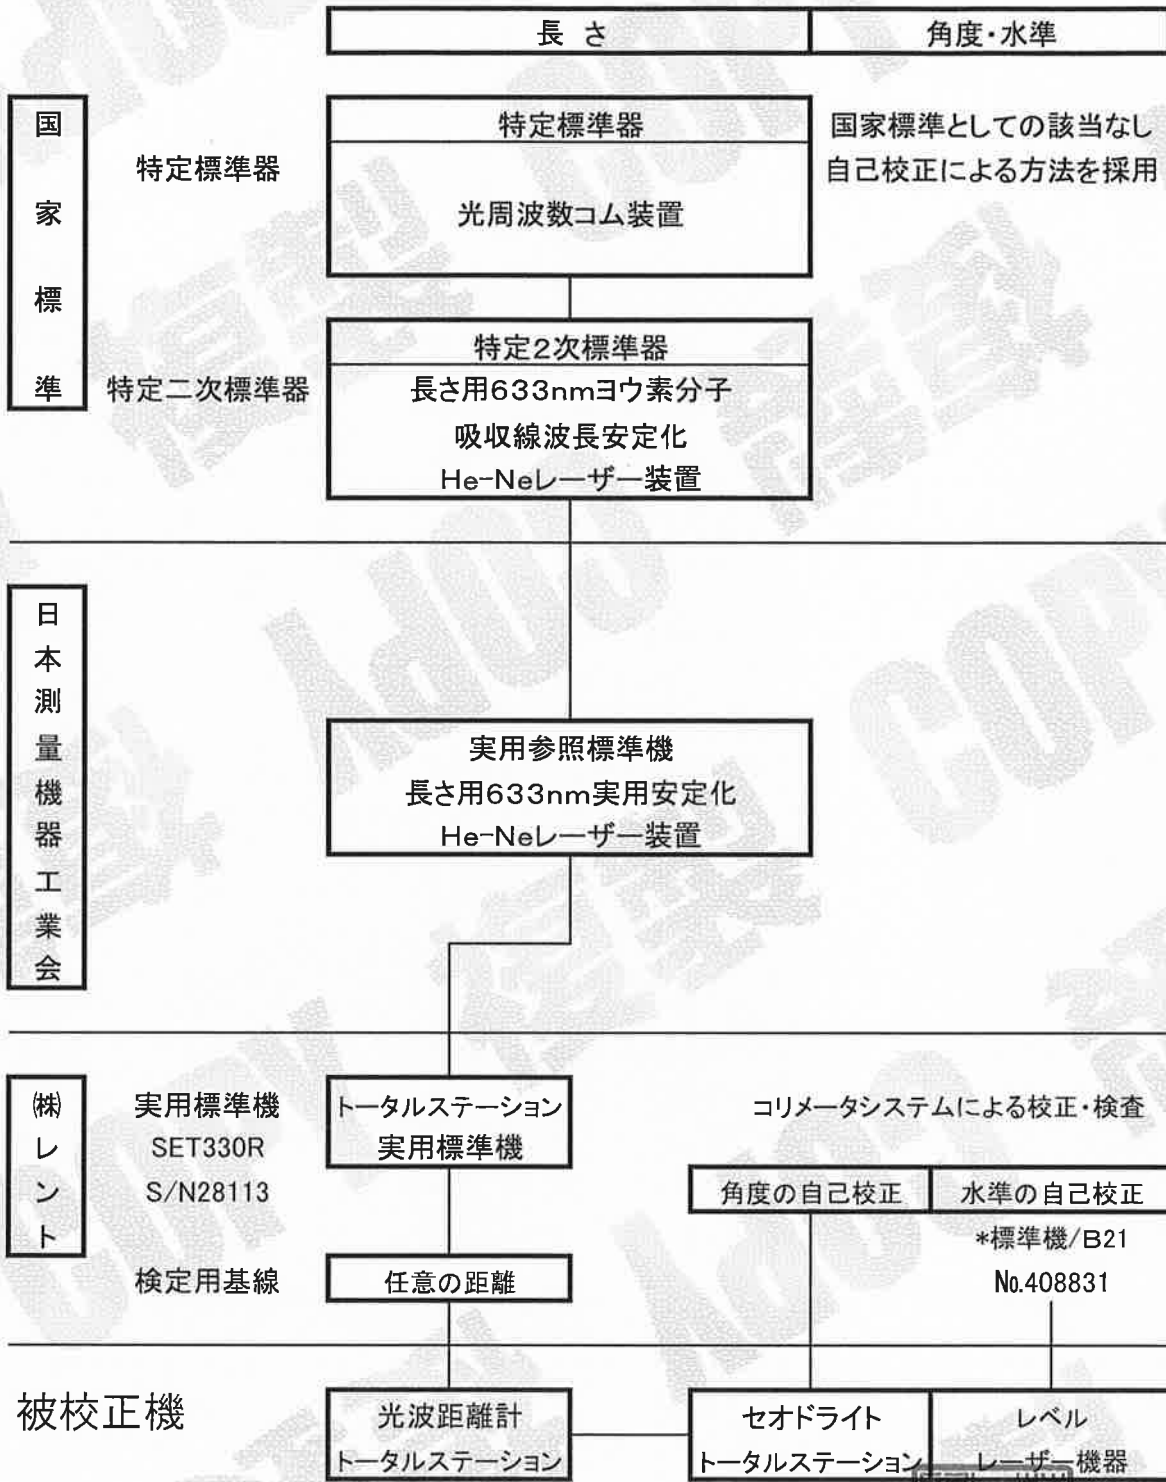

株式会社 レント「測機・工具センター」  
 静岡県藤枝市横内849-1  
 Tel/054-645-6615